

中华人民共和国国家标准

GB/T 1158—2008
代替 GB 1158—1989

高温试验箱 术语和定义

Specifications for high temperature test chambers

高温试验箱
术语和定义

发布

2008-06-30 发布

2009-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 使用条件	2
5 技术要求	2
6 试验方法	3
7 检验规则	7
8 标志、包装、贮存	9
附录 A (资料性附录) 可疑数据判别方法	10
附录 B (资料性附录) 温度偏差的测量不确定度评定	11

...

前 言

本标准是“环境试验设备技术条件”系列标准之一。该系列标准由以下几项标准组成：

- GB/T 10586—2006 湿热试验箱技术条件
- GB/T 10587—2006 盐雾试验箱技术条件
- GB/T 10588—2006 长霉试验箱技术条件
- GB/T 10589—2008 低温试验箱技术条件
- GB/T 10590—2006 高低温/低气压试验箱技术条件
- GB/T 10591—2006 高温/低气压试验箱技术条件
- GB/T 10592—2008 高低温试验箱技术条件
- GB/T 11158—2008 高温试验箱技术条件
- GB/T 11159—2008 低气压试验箱技术条件

本标准代替 GB/T 11158—1989《高温试验箱技术条件》。

本标准与 GB/T 11158—1989 相比主要变化如下：

- 增加了“术语和定义”一章，内容采用 IEC 60068-3-5 中的相应部分；
- 按 IEC 60068-3-5 的温度波动度的概念，将温度波动度改为 1℃(见表 1)；
- 按 IEC 60068-3-5 的温度数据记录要求，将温度每分钟记录一次数据(见 6.3)；
- 按 IEC 60068-3-5 的升温速率测试方法，将升温速率测试方法(见 6.5)；
- 扩大了使用环境条件大气压的范围(见 4.1)；
- 修改了温度等级(见表 1)；
- 修改了风速要求(见表 1)；
- 升温条件除升温速率外，增加了温度保持时间(见表 1)；
- 修改了安全保护措施，增加了电气绝缘强度的要求(见 5.3)；
- 测试条件改在 20℃±5℃(见 6.2)；
- 增加了温度均匀性评定方法及其应用的信息(见附录 B)。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准归口单位：仪器仪表及设备标准化技术委员会。

本标准起草单位：重庆银河试验仪器有限公司、上海爱斯佩克环境设备有限公司、信息产业部电子第五研究所、上海试验仪器厂有限公司。

本标准参加单位：重庆四达试验设备有限公司、无锡苏南试验设备有限公司、成都天宇试验设备有限公司、湖南省计量检测研究院。

本标准主要起草人：王华斌、陆礼明、赖文光、冯明康、陈云生、倪一明、蒯正心、李庆先、许清禄。

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 11158—1989。

高温试验箱技术条件

1 范围

本标准规定了高温试验箱(简称“试验箱”)的术语和定义,使用条件、技术要求、试验规则及标志、包装、贮存。

本标准适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行高温试验的产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志(ISO 780:1997)

GB 14048.1—2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 (IEC 60947-1:2001,MOD)

JB/T 9512—1999 气候环境试验设备与试验方法 第1部分:总则

JJF 1059—1999 测量不确定度评定与表示

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

试验箱 test chamber

其中某部分能满足规定的试验条件,并能保持一定温度和空间。

3.2

温度设定值 temperature setting

用试验箱控制装置设定的温度值。

3.3

实际温度 actual temperature

稳定后,在规定的任意时间间隔内,工作空间内任意一点的温度。

3.4

温度稳定 temperature stabilization

在规定的任意时间间隔内,工作空间内任一点的温度均达到温度设定值并维持在规定的容差范围内。

3.5

温度波动 temperature fluctuation

稳定后,在规定的任意时间间隔内,工作空间内任一点的最高和最低温度之差。

3.6

工作空间 working space

试验箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的部分。

3.7

温度梯度 temperature gradient

稳定后,在任意时间间隔内,工作空间内任意两点的温度平均值之差的极大值。

3.8

温度变化速率 temperature rate of change

在工作空间中心测得的两个给定温度之间的转变率,以℃/min 为单位。

3.9

温度偏差 temperature variation

稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心温度的平均值和工作空间内其他点温度的平均值之差。

3.10

极限温度 temperature extremes

稳定后,工作空间内所达到的最高和最低温度。

4 使用条件

4.1 环境条件

- a) 温度 5℃~40℃;
- b) 相对湿度:不大于 85%RH;
- c) 大气压 80 kPa~106 kPa;
- d) 周围无强烈振动;
- e) 无阳光直接照射或其他热源直接辐射;
- f) 周围无强烈气流:当周围空气需强制流动时,气流应直接吹到箱体上;
- g) 周围无强电磁场影响;
- h) 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。

4.2 供电条件

- a) 交流电压 220 V±22 V;
- b) 频率 50 Hz±0.5 Hz

4.3 负载条件

试验箱的负载应同时满足下列条件:

- a) 负载的总质量应小于工作室容积内放置不超过 80 kg;
- b) 负载的总表面积应小于工作室容积的 1/5;
- c) 在垂直于气流方向的截面上,负载面积之和应不大于该处工作室截面积的 1/3,负载置放时不得产生气流扰动。

5 技术要求

5.1

温度变化速率
在试验箱内,温度变化速率及指标见表 1。

表 1 试验箱性能项目及指标

序号	性能项目	单位	规定值
1	温度范围 ^a	℃	(室温+15)~200
2	温度偏差	℃	±2
3	温度梯度	℃	≤2
4	温度波动度	℃	≤1
5	设定值与中心温度平均值之差	℃	±2

表 1 (续)

序号	性能项目	单位	规定值
6	工作室内壁温度与工作空间温度之差	K	应不高于试验箱温度的 3%
7	升温速率 ^b	℃/min	一般情况下,试验箱每 5 min 的平均升温速率应不大于 1℃/min。试验样品对升温速率不敏感时,项目可用升温时间替代
8	风速 ^c	m/s	≤1.7 或 7
a 温度范围超过 200℃时,温度偏差、温度梯度可适当放宽。 b 由制造商在产品技术文件中规定最快升温时间;升温时间是指试验箱工作温度至高工作温度的时间。 c 由制造商在产品技术文件中规定风速。			

5.2 产品结构及外观要求

- 5.2.1 试验箱内壁应使用耐热不易氧化、耐腐蚀和具有一致足下测要求的测洱制造,应无影响试验的污染源。
- 5.2.2 保温材料应能耐高温并具有阻燃性能。
- 5.2.3 保温层的厚度应保证试验箱外部易触及部 在 不 高 于 环 境 温 度 +35℃。
- 5.2.4 加热器件不应构成对样品的直接辐射。≤列要求 的 测 温 系 统
- 5.2.5 应设有引线孔。
- 5.2.6 箱门的密封性能应良好,密封条应 1. 耐 温 且 便 于 更 换。
- 5.2.7 应有放置或悬挂试验样品的样 , 样 品 应 有 良 好 耐 热 不 易 氧 化 和 耐 腐 蚀 性 能。
- 5.2.8 外观涂镀层应平整光滑、色 泽 均 匀 , 不 得 有 露 底、起 泡、起 层 或 擦 伤 痕 迹。

5.3 安全和环境保护要求

- 5.3.1 电源接线端子对箱体 外 壳
 - 绝缘电阻值应满 足 ≥2 MΩ,热态电阻≥1 MΩ;
 - 应能承受 50 F 00 压,施压时间为 5 s 的耐电压试验。
- 5.3.2 保护接地端 应 与 箱 体 外 壳 电 气 联 接 及 接 线,应 符 合 GB 14048.1—2006 的 7.1.9 的 规 定。
- 5.3.3 应有超温 报 警 装 置。
- 5.3.4 整机噪 声 功 率 级 不 应 大 于 70 dB。

6 试验方

6.1 试 验 器 与 装 置

- 6.1.1 风 速 仪
 - 性能项
 - 风速仪应 低 于 0.05 m/s 的 风 速 仪。
- 6.1.2 温 度 计
 - 采用铂电阻、热电偶或其他类似温度传感器组成的并满足下列要求的测温系统:
 - 传感器时间常数:20 s~40 s。
 - 测温系统的扩展不确定度(k=2):不大于 0.4℃。
- 6.1.3 表 面 温 度 计
 - 采用铂电阻或其他类似传感器组成并满足下列要求的测温系统。
 - 传感器时间常数:20 s~40 s。
 - 测温系统扩展不确定度(k=2):不大于 1.0℃。

6.2 测试条件

6.2.1 测试条件应满足 4.1 和 4.2 的要求。

6.2.2 测试在空载条件下进行。

6.3 温度测试方法

6.3.1 测试点的位置及数量


6.3.1.1 在试验箱工作室定出上、中、下三个测试面,简称上、中、下层。上层与工作室顶面的距离为工作室高度的 1/10,中层通过工作室几何中心,下层在最低层样品架上方 10 mm。

注:工作室具有斜顶或尖顶时,顶面为通过斜面与垂直壁面交线的假想水平面。

6.3.1.2 测试点位于三个测试面上,中心测试点位于工作室几何中心,其到侧壁的距离为各自边长的 1/10(图 1)。但对工作室容积不大于 1 m^3 的试验箱,该距离为 50 mm。

6.3.1.3 测试点的数量与工作室容积大小的关系为:


a) 工作室容积不大于 2 m^3 时,测试点为 9 个,布置位置如图 1。

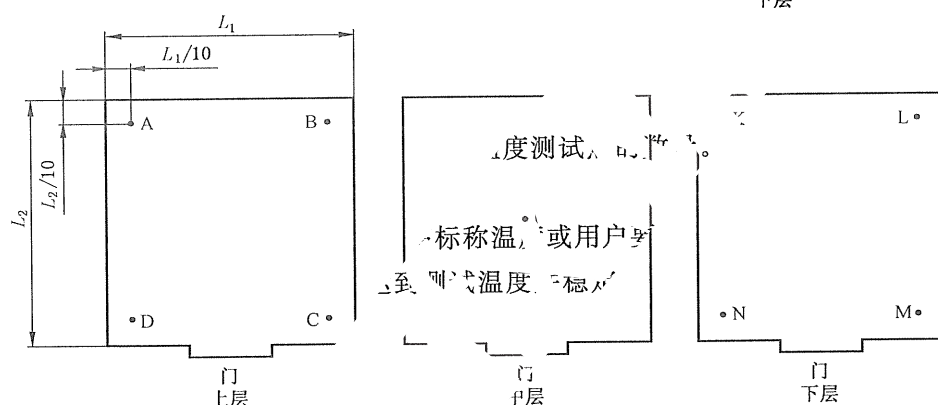

A, B, ..., M, N——温度测试点

图 1

b) 工作室容积大于 2 m^3 时,测试点为 15 个,布置位置如图 2 所示。

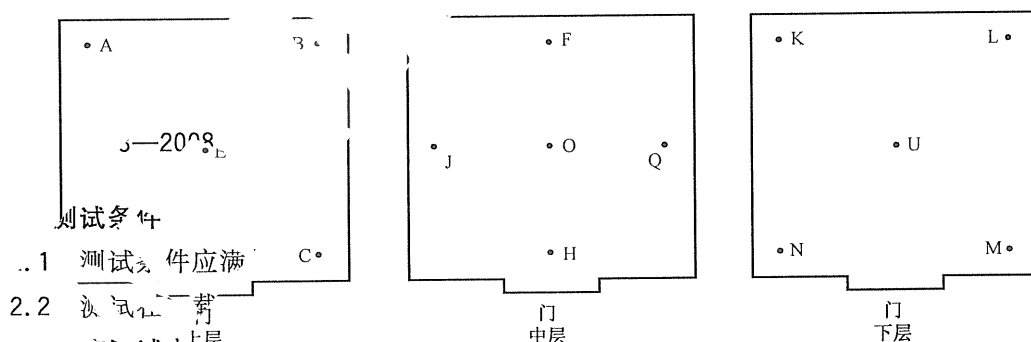

A, B, ..., N, U——温度测试点

图 2

c) 当工作室容积大于 50 m^3 时,应适当增加温度测试点的数量。

6.3.2 测试程序

6.3.2.1 在试验箱温度可调范围内,选取最高标称温度或用户要求的温度作为测试温度。

6.3.2.2 在工作空间中心测试点的温度达到测试温度并稳定 2 h,每隔 1 min 测试所有测试点的温度 1 次,在 30 min 内共测 30 次。

6.3.3 数据处理和试验结果

6.3.3.1 对测得的温度数据,按测试仪表的修正值进行修正。

6.3.3.2 剔除可疑数据(参考附录 A)。

6.3.3.3 对在温度恒定阶段测得的数据(即 6.3.2.2 测得的数据),按式(1)计算每点 30 次测得的温度平均值:

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:

 $\bar{T}$ ——温度平均值,单位为摄氏度(℃); T_i ——第 i 次测试值,单位为摄氏度(℃); n ——测量次数。

6.3.3.4 按式(2)计算温度梯度:

$$\Delta T_j = \bar{T}_h - \bar{T}_L \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

表 1 中温度偏差 ΔT ΔT_j ——温度梯度,单位为摄氏度(℃); $\bar{T}_h$ ——温度平均值的最大值,单位为摄氏度(℃); 附录 B)。 $\bar{T}_L$ ——温度平均值的最小值,单位为摄氏度(℃)。

6.3.3.5 按式(3)计算温度波动度:

$$\Delta T_b / \text{传感器在工作室内} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

 ΔT_b ——温度波动度,单位为摄氏度(其他装置测试值) T_{ih} ——工作空间第 i 点的最高温度,单位为摄氏度(℃); T_{iL} ——工作空间第 i 点的最小温度,单位为摄氏度(℃)。

6.3.3.6 按式(4)计算温度偏差:

$$\Delta T_i = \bar{T}_i - \bar{T}_0 \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

 ΔT_i ——温度偏差,单位为摄氏度(℃); $\bar{T}_0$ ——工作空间中心点的温度平均值,单位为摄氏度(℃); $\bar{T}_i$ ——工作空间第 i 点的温度平均值,单位为摄氏度(℃)。

6.3.3.7 按式(5)计算设定值与中心温度平均值之差:

$$\Delta T_s = T_s - \bar{T}_0 \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

 ΔT_s ——设定值与中心温度平均值之差,单位为摄氏度(℃);

6.3.3.8 对可疑数据,按 6.3.3.2 剔除可疑数据。

6.3.3.9 试验箱控制仪表的设定值与中心测试值之差应满足表 1 中温度偏差的要求。以上计算结果均应符合表 1 的规定。

6.3.3.9 根据实际需要,评定测量结果的不确定度(参考附录 B)。

6.4 工作室内壁与工作空间的温度差的测试方法

6.4.1 测试点布置位置及数量

6.4.1.1 在工作空间几何中心布置 1 个温度传感器;在工作室六面内壁几何中心各布置 1 个表面温度传感器。

6.4.1.2 若工作室内壁中心有引线孔或其他装置,则测试点与孔壁或其他装置的距离应不小于 100 mm。

6.4.2 测试程序

6.4.2.1 在试验箱温度可调范围内,选用最高标称温度为测试温度。

6.4.2.2 在工作空间几何中心点的温度第一次达到测试温度并稳定 2 h,每隔 2 min 测试所有测试点的温度值 1 次,共测 5 次。

6.4.3 试验结果的计算与判定

6.4.3.1 将测得的温度值按测试仪表的修正值修正。·····

6.4.3.2 分别计算各测试点温度的算术平均值。

6.4.3.3 将工作室内壁与工作空间几何中心测试点温度的平均值代入式(6):

$$A = \frac{|\bar{T}_n - \bar{T}_0|}{\bar{T}_0} \times 100\% \quad \cdots \cdots \cdots (6)$$

式中:

A——工作室内壁与工作室热力学温度之差的百分比;

$\bar{T}_n$ ——工作室内壁测试点的平均热力学温度,单位为开尔文(K);

$\bar{T}_0$ ——工作空间几何中心测试点的平均热力学温度,单位为开尔文(K)。

其结果应符合表 1 的规定。

6.5 升温速率测试方法

6.5.1 测试点

测试点为工作空间几何中心点。

6.5.2 测试程序

6.5.2.1 在试验箱温度可调范围内,选取室温升最高各测试点,最高标称温度为最高规定温度。

6.5.2.2 开启热源,使试验箱由室温升最高,检测试验箱温度从温度范围的 10% 升到 90% 的时间。

6.5.2.3 在升温过程每 1 min 记录一次温度。

6.5.3 试验结果的计算与评定

6.5.3.1 将测得的温度值按测试仪表的修正值修正。

6.5.3.2 按式(7)计算升温速率。

$$V_T = \frac{0.8 \times (T_2 - T_1)}{t} \quad \cdots \cdots \cdots (7)$$

式中:

V_T ——升温速率,单位为摄氏度每分钟(°C/min);

T_1 ——试验开始温度,单位为摄氏度(°C);

T_2 ——试验结束温度,单位为摄氏度(°C);

t——在试验箱温度从 10% 升到 90% 的升温时间,单位为分钟(min)。

其结果应符合表 1 的规定。

6.6 风速测试方法

6.6.1 测试条件

本测试在空载和室温条件下进行。

6.6.2 测试点

测试点的数量及位置与 6.3.1 相同。

6.6.3 测试程序

6.6.3.1 将细棉纱线或其他轻飘物体悬挂于测试点,关闭箱门开启风机,找出各测试点的主导风向。

6.6.3.2 将风速传感器置于测试点,关闭箱门后测出各测试点主导风向的风速值。

6.6.4 试验结果的计算与评定

6.6.4.1 将测得的风速值按风速仪的修正值修正。

6.6.4.2 按式(8)计算所有测试点风速的平均值:

$$V = (V_A + V_B + \cdots + V_M) / n \quad \cdots \cdots (8)$$

式中:

 V ——试验箱风速,单位为米每秒(m/s); $V_A, \cdots, V_M$ ——测量点的风速,单位为米每秒(m/s); n ——测量点的数量。

计算结果应符合表1的规定。

6.7 保温层保温性能测试方法

试验箱温度稳定在最高工作温度点测试。用表面温度计检查(箱内腔框架、引线孔及门框边100 mm范围除外)的温度,其结果应符合5.2.3的要求。检查一次。外观检查。

6.8 箱门密封性能测试方法

6.8.1 6.3~6.8的试验开始前及全部结束后各检查一次。

6.8.2 将厚0.1 mm、宽50 mm、长200 mm的纸条垂直放在箱门密封条之间的任一部位,关闭箱门后,用手轻拉纸条,如不能自由滑动,即符合5.2.4的要求。

6.9 噪声测试方法

试验箱整机噪声的测试方法见JB/T 9512—1999,结果应符合5.3.4的规定。

6.10 安全保护性能测试方法

6.10.1 电绝缘及保护接地端子的测试

6.10.1.1 电源接线端子对箱体金属部分的耐压试验,采用5 kV耐压测试仪,在6.3试验前进行,其结果应符合5.3.1的要求。

6.10.1.2 绝缘电阻及保护性接地端子测试采用500 V准确度为1.0级绝缘电阻测量仪,在6.3试验前后各进行一次,其结果应符合5.3.1和5.3.2的要求。

6.10.2 安全保护装置

6.10.2.1 在试验箱内,按表1规定的温度范围中任选3个温度作为试验温度。

6.10.2.2 将超温保护装置温度设定为测试温度,然后升温。当工作空间几何中心点的温度到达设定温度时超温保护装置动作(停止加热)并同时发出报警信号即符合5.3.3的要求,本试验应连续进行三次。

6.10.2.3 检查是否有过电流等保护及报警装置。在试验过程中,如报警及保护装置每次均动作即符合试验结果的要求。

6.4.1 将测得的风速值按风速仪的修正值修正。

6.4.2 按式(8)计算所有测试点风速的平均值。

6.4.2.1 按式(8)计算。应在6.3~6.10规定的试验前和试验后各检查一次。外观涂镀层应符合5.2.8规定。

7 检验规则

7.1 检验类型

试验箱的检验分型式检验和出厂检验两类。

7.2 检验项目

型式检验和出厂检验的项目见表2。

表 2 检验项目

序号	检验项目	技术要求章条号	试验方法章条号	型式检验	出厂检验
1	外观质量	5.2.8	6.11	○	○
2	箱门密封性	5.2.6	6.8	○	○
3	噪声	5.3.4	6.9	○	—
4	安全保护性能	5.3.1~5.3.3	6.10	△。	○
5	保温性能	5.2.3	6.7	第二次抽检合格时， 有 1 台不合格，则判	○
6	温度偏差	表 1 序号 2	6.3	○	○
7	温度梯度	表 1 序号 3		○	○
8	温度波动度	表 1 序号 4		—	○
9	设定值与中心温度平均值之差	表 1 序号 5		○	○
10	内壁与工作空间温差	表 1 序号 6	—	○	—
11	升温速率(升温时间)	表 1 序号 7	—	○	○
12	风速	表 1 序号 8	6.1	○	—

注：有“○”者为应检验项目。

7.3 型式检验

7.3.1 应进行型式检验的情形

- a) 新产品试制定型鉴定；
- b) 正式生产的产品在结构、材料、生产工艺、设备和管理等方面有较大改变，可能影响产品性能时；
- c) 国家质量监督机构进行质量监督抽查时；
- d) 出厂试验结果与上次型式试验结果有较大差异时；
- e) 产品停产一年以上；
- f) 产品批量生产时，应按规定的定期抽检。

7.3.2 抽样及判定规则

- 7.3.2.1 成批生产的产品，批量在 20 台以上时，抽检 2 台；不足 20 台时，抽检 1 台。
- 7.3.2.2 抽检样品应全部合格，否则，对不合格项目加倍抽检。第二次抽检合格时，仅将第一次抽检不合格项目，检验合格后允许出厂；如第二次抽检样品中仍有 1 台不合格，则判该批产品不合格；如第二次抽检样品全部合格，则判该批产品合格。

7.4 出厂检验

7.4.1 出厂检验项目

1 外观质量由制造厂质量检验部门负责。

7.4.2 检验条件

本检验在空载条件下进行。

7.4.3 检验项目

- 7.4.3.1 检验项目见表 2。
- 7.4.3.2 除温度梯度及温度偏差采用抽样检验外，其他项目应逐台进行检验，检验项目均应合格。
- 7.4.4 抽样及判定规则
- 7.4.4.1 温度梯度及温度偏差的出厂抽检量按产品批量的 10% 计算，但不得少于 2 台。
- 7.4.4.2 检验项目应全部合格，如有 1 台不合格，应加倍抽检；第二次抽检合格时，仅将第一次抽样不

合格产品返修,检验合格后允许出厂,如第二次抽检仍有 1 台不合格,则应对该批产品逐台检验。

8 标志、包装、贮存

8.1 标志

8.1.1 试验箱的铭牌,字迹应清晰耐久,固定牢靠。

8.1.2 铭牌的内容应包括:

- a) 产品型号、名称;
- b) 温度范围;
- c) 电源电压、频率及总功率;
- d) 制造日期或制造批号;
- e) 制造单位名称。

8.2 包装

8.2.1 包装箱的文字及标志应符合 GB/T 191—2008 的规定。

8.2.2 包装箱应牢固可靠。

8.2.3 包装箱应防雨淋、防潮气聚集。

8.2.4 试验箱的附件、备件和专用工具应单独包装,牢固固定于包装箱内。

8.2.5 试验箱的技术文件如装箱清单、产品使用说明书、合格证等应密封防潮,固定在包装箱内明显的地方。

8.3 贮存

8.3.1 包装完备的试验箱应贮存在通风良好、干燥、无腐蚀性气体、化学药品的库房内。

8.3.2 贮存期长达一年以上的试验箱,出厂前应重新进行出厂检验,合格后方可出厂。

品返修,检验合格

标志、包装、贮存

试验

附 录 A
(资料性附录)
可疑数据判别方法

A.1 对一组修正后的测试数据的某个极大或极小值有怀疑时,应利用专业知识找出原因。在未判明它是否合理前,既不要轻易保留,也不要随意剔除,可用下述方法判别,决定取舍。

A.2 利用式(1)、式(A.1)算出数据的平均值及单次测得值的标准偏差:

$$S(T_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n-1}} \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

T_i ——第 i 次测量值,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

$\bar{T}$ ——温度平均值,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

$S(T_i)$ ——单次测得值的标准偏差,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

n ——测量次数。

A.3 求格拉布斯准则计算统计量:

$$G(n) = (T_{(n)} - \bar{T}) / S(T_i) \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

式中:

$T_{(n)}$ ——测量数据的极大值或极小值,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

A.4 对于本标准,取显著水平 $\alpha=0.01$,并查表得 $G_{99}(n)$ 值:

当 $n=30$ 时, $G_{99}(n)=3.103$;

$n=29$ 时, $G_{99}(n)=3.085$

$n=28$ 时, $G_{99}(n)=3.066$

$n=27$ 时, $G_{99}(n)=3.050$

当 $|G(n)| > G_{99}(n)$ 时,应剔除可疑值,并重新按式(1)、式(A.1)和式(A.2)计算剩下数值的平均值及标准偏差和 $G(n)$,继续检验可疑数据为止。

附录 B (资料性附录)

温度偏差的测量不确定度评定

B.1 温度偏差的测量不确定度评定依据为 JJF 1059—1999《测量不确定度评定与表示》。

B.2 温度偏差的测量不确定度评定的主要流程如下：

- a) 建立数学模型,确定被测量 Y 与输入量 $X_1, \dots, X_n$ 的关系;
- b) 求最佳值,由 X_i 的最佳值 x_i 求得 Y 的最佳值 y ;
- c) 列出测量不确定度来源;
- d) 标准不确定度分量评定:A类评定和B类评定;
- e) 计算合成标准不确定度;
- f) 评定扩展不确定度;
- g) 不确定度报告。

B.3 温度偏差的测量不确定度评定的主要步骤如下：

- a) 根据温度偏差的定义,其测量过程的数学模型为
- b) 求最佳值:
 T_i 的最佳值为工作空间其他点在 30 min 内的温度测量值的算术平均值 $\bar{T}_i$, T_0 的最佳值为工作空间中心点在 30 min 内的温度测量值的算术平均值 $\bar{T}_0$,均按式(1)计算。

因此,温度偏差的最佳值 ΔT_i 就是

- c) 列出测量不确定度来源

温度偏差的测量不确定度主要来源有：

- 由于各种随机因素影响,工作空间其他点在 30 min 内的温度测量值数据不重复引入的标准不确定度 u_1 ;
- 测试工作空间其他点温度时,由于测温系统的不准确引入的标准不确定度 u_2 ;
- 由于各种随机因素影响,工作空间中心点在 30 min 内的温度测量值数据不重复引入的标准不确定度 u_3 ;
- 测试工作空间中心点温度时,由于测温系统的不准确引入的标准不确定度 u_4 。

- d) 标准不确定度分量评定

- 按 A 类评定,工作空间其他点在 30 min 内的温度测量值的算术平均值 $\bar{T}_i$ 的实验标准差就是标准不确定度 u_1 ;工作空间中心点在 30 min 内的温度测量值的算术平均值 $\bar{T}_0$ 的实验标准差就是标准不确定度 u_3 ;均按式(A.1)和式(B.1)计算:

$$S(\bar{T}) = \frac{S(T_i)}{\sqrt{n}} \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

标准不确定度 u_2 应是测温系统测试工作空间其他点温度时的合成标准不确定度,标准不确定度 u_4 应是测温系统测试工作空间中心点温度时的合成标准不确定度。

其中,标准不确定度分量 u_1 、 u_2 、 u_3 和 u_4 互不相关,不确定度传播律公式(B.2)为:

$$u_c^2 = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2 \quad \dots\dots\dots (B.2)$$

- e) 计算合成标准不确定度 u_c 见式(B.3)

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2} \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

- f) 评定扩展不确定度 U

按置信水平 $P=0.95$, 取包含因子 $k=2$, 扩展不确定度式(B.4)为

$$U = 2 \times u_c \dots\dots\dots (B.4)$$

g) 不确定度报告

温度偏差的测量不确定度可用如式(B.5)形式表示:

$$\Delta T_i = \overline{T_i} - \overline{T_0} \pm U \dots\dots\dots (B.5)$$

例如:上偏差 $\Delta T_{\max} = (1.0 \pm 0.3)^\circ\text{C}, k=2$;
下偏差 $\Delta T_{\min} = (-1.5 \pm 0.2)^\circ\text{C}, k=2$ 。

h) 如果温度偏差的测量不确定度为最大温度偏差值的 1/10~1/3 时,测量不确定度对判定测试结论的影响可忽略不计。若计算出的温度偏差合格,则说明试验箱的精度满足要求。

B.4 试验箱其他技术性能的测量不确定度评定亦可参照上述方法进行。

2008

不确定度报告
温度偏差的
例如:

社 出 版 发 行
三 里 河 北 街 16 号
编 码 : 100045

www.spc.net.cn

电 话 : 68523946 68517548

中 国 标 准 出 版 社 秦 皇 岛 印 刷 厂 印 刷

各 地 新 华 书 店 经 销

*

开 本 880×1230 1/16

2008 年 11 月 第 一 版

书 号 : 155066

如 有

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
高 温 试 验 箱 技 术 条 件
GB/T 11158—2008

*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北 京 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号
邮 政 编 码 : 100045

网 址 www.spc.net.cn

电 话 : 68523946 68517548

中 国 标 准 出 版 社 秦 皇 岛 印 刷 厂 印 刷

各 地 新 华 书 店 经 销

*

开 本 880×1230 1/16 印 张 1.25 字 数 25 千 字

2008 年 11 月 第 一 版 2008 年 11 月 第 一 次 印 刷


*

书 号 : 155066 · 1-33984

如 有 印 装 差 错 由 本 社 发 行 中 心 调 换

版 权 专 有 侵 权 必 究

举 报 电 话 : (010)68533533

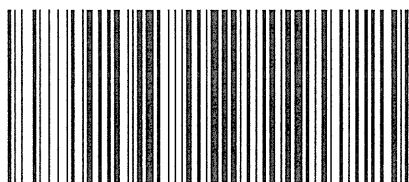

GB/T 11158—2008