


B 所有功能汇总

仪器功能表【一】	
Param 【参数】	L-Q C-D R-Q Z-D Z-Q
View 【显示】	D/Q Z d 【相位角度】 r 【相位弧度】 Δ 【绝对偏差】 % 【相对偏差】 分选结果
Rate 【速度】	F 【快速】 M 【中速】 S 【慢速】
Clear 【清零】	请参考 【3.5.11 清零 (Clear)】
Shift Equivalent 【等效方式】	SER 【串联】 PAL 【并联】
Shift View Off 【关显示】	第三显示关
Shift Beeper 【讯响设置】	P1-P3, HI, IN, LO, AUX, NG, OFF
Shift Relative 【关清零】	屏显【REL】: 清零值有效。
SRes 【源阻】	30Ω 50Ω 100Ω
Comp 【比较器设置】	
AUX 【附属档】	ON 【开】 OFF 【关】
Freq 【频率】	50, 60, 100, 120, 1k, 10k, 20k, 40k, 50k, 100k 【10 点频率】
Level 【电平】	选择 0.1V, 0.3V, 1V 电平
Range 【量程】	屏显【AUTO】: 自动量程
Avg 【平均次数】	0~99 次平均

仪器功能表【二】

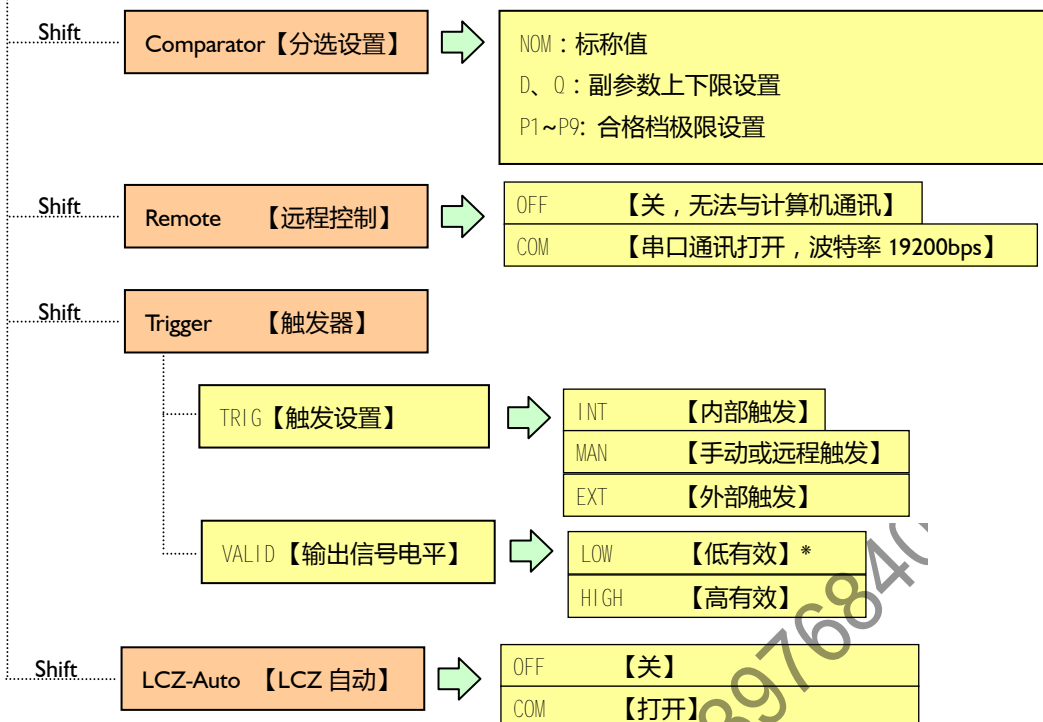

联系电话: 0512-63976841